PROVENT Plus Mini



- Membrana intrinsecamente idrofobica
- Elevata permeabilità ai gas
- Materiali in accordo ai requisiti FDA-CFR21
- Sterilizzabilità
- Assemblaggio per termosaldatura
- Estraibili in accordo a USP per materiali plastici
- Validation Guide disponibile a richiesta

La cartuccia PROVENT Plus Mini è progettata specificatamente per l'utilizzo nei filtri di sfiato di serbatoi contenenti prodotti che non devono essere contaminati dall'aria richiamata durante l'operazione di svuotamento. La selezione dei materiali, sia della struttura che del filter media, rende la cartuccia adatta anche per la filtrazione sterilizzante dell'aria utilizzata nei processi di fermentazione, purchè la temperatura non superi i valori indicati in tabella.
La costruzione avviene in camera bianca certificata; tutte le cartucce sono sottoposte a test di integrità correlati a test di ritenzione microbiologica condotti a campione sul lotto di produzione.

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Filter media	membrana in PTFE
Supporto a monte	polipropilene
Supporto a valle	polipropilene
Canotto interno	polipropilene
Canotto esterno	polipropilene
Terminali	polipropilene

DIRETTIVE EC
IDONEITA' CONTATTO INDIRETTO CON ALIMENTI

Le cartucce PROVENT Plus Mini sono in accordo al D.M. 21/3/73 (S.O. della G.U. n° 104 del 20.04.73) e successivi aggiornamenti e al regolamento (CE) 1935/2004.

SICUREZZA BIOLOGICA ED ESTRAIBILI

I materiali superano i test tossicologici previsti da USP-CLASSE VI e le prove chimico fisiche previste da USP-Materie Plastiche.

STANDARD QUALITATIVI

Prodotte in conformità al Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001; 2008 e in accordo alle procedure interne al fine di garantire la tracciabilità e l'integrità.


CONDIZIONI OPERATIVE


- max. temperatura in continuo	70 °C
- tempo max cumulativo di sterilizzazione con vapore	100 cicli di 60 minuti a 140 °C
- sanitizzazione chimica	compatibile con ampia gamma di sanitizzanti
- max. pressione differenziale	5,0 bar a 25 °C
- perdita di carico raccomandata per la sostituzione	2,0 bar a 25 °C

CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE ASSOLUTO IN LIQUIDI	3) RITENZIONE DI CARICA BATTERICA >10^7 CFU/cm^2	LIMITE ACCETTABILITA' PER TEST DI INTEGRITA'
SM	0,2 µm	Brevundimonas diminuta in liquido	1) ≤ 7 ml/min @ 0,8 bar
	0,2 µm	Batteriofago T1 in aerosol	1) ≤ 7 ml/min @ 0,8 bar
SMA	0,2 µm	Brevundimonas diminuta in liquido	2) ≤ 8 Nml/10min @ 2,5 bar

Note:
1– L'integrità viene verificata con il test di DIFFUSIONE bagnando la cartuccia con una soluzione acquosa di alcool isopropilico IPA 50/50 V/V.
2– L'integrità viene verificata con il test di INTRUSIONE con acqua.
3– Il test di RITENZIONE DI CARICA BATTERICA è condotto secondo ASTM F838

CURVE DI PORTATA CON ARIA

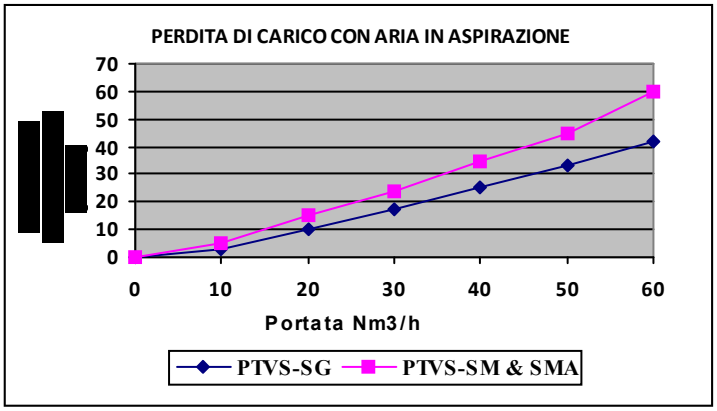

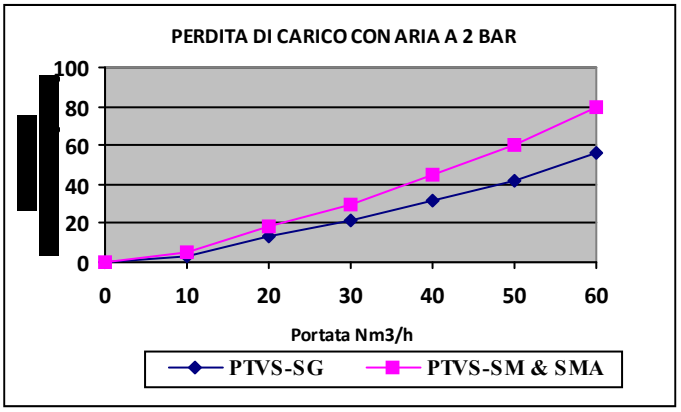

SELEZIONE CODICI PER ORDINARE PROVENT Plus Mini

PTVS - 100 1 - SM - PH SB - ☐

TERMINALE	CODICE
SOE: Singolo terminale aperto con O-Ring interno 2.116	**100**
SOE: Singolo terminale aperto con estremità filettata da 1/2"	**120**

GRADO FILTRAZIONE ASSOLUTO MICRON	CODICE
0,2	**SM***
0,2	**SMA ****
0,45	**SG ++**

* Integrità verificabile con test di diffusione in IPA
** Integrità verificabile con test di intrusione con acqua
++ Modalità e valori test integrità a richiesta

CODICE	IMBALLO
SB	Scatola singola

GUARNIZIONI		CODICE
Standard	Silicone	**Nessun codice**

CODICE	LUNGHEZZA NOMINALE
1	135 mm
05	142 mm Estremità filettata inclusa

CODICE	PRODUCT GRADE
BG	Biological grade
PH	"Grado apirogeno". Certificato di qualità nella confezione.
PHH	"Grado apirogeno". Certificato di qualità nella confezione con serial number.

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.

Bea Technologies Spa
Via Newton,4 -20016 Pero (MILANO) Italy
Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
mail:info@bea-italy.com
web:www.bea-italy.com